

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

Delibera del Direttore Generale n. 694 del 03/04/2023

OGGETTO: ID 21A170_4 - Fornitura di "Pensili e scialitiche" per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia e della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale-Università Padova. Aggiudicazione della fornitura ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta telematica Sintel n. 158162016

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento si aggiudica definitivamente la fornitura di "Pensili e scialitiche" per le sale operatorie per reparti vari dell'Azienda Ospedale-Università Padova, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura aperta telematica Sintel ID 158162016.

Il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** riferisce:

Con deliberazione del Direttore Generale n. 1649 del 05/08/2022 è stata indetta la procedura di affidamento, ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante procedura telematica SINTEL n. 158162016, per la fornitura di "Pensili e scialitiche" per la UOC Neurochirurgia e UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale – Università Padova per un importo a base d'asta di € 203.700,00 IVA esclusa.

Il criterio di aggiudicazione prevede l'aggiudicazione della fornitura, lotto per lotto, alla ditta offerente il miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 con i seguenti criteri: qualità 70 punti, prezzo 30 punti.

Entro il termine perentorio per la presentazione delle offerte, 19 settembre 2022, hanno presentato offerte le seguenti ditte per i lotti di seguito indicati:

- ✓ CS Med S.r.l. per i lotti 1 e 2
- ✓ Getinge Italia S.r.l. per i lotti 1 e 2
- ✓ I.M. Medical S.a.s. per i lotti 1 e 2
- ✓ Laite S.r.l. per il lotto 1

In data 03/10/2022 si è svolta la seduta di apertura delle buste

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

amministrative e di verifica della documentazione richiesta, in data 06/10/2022 si è svolta la seduta di verifica del soccorso istruttorio chiesto alla ditta I.M. Medical S.a.s., a seguito del quale è stata ammessa al prosieguo della procedura, come da verbali allegati alla delibera n. 2385 del 11/11/2022 di nomina della Commissione Giudicatrice.

A seguito della seduta per l'apertura della busta telematica contenente l'offerta economica delle ditte ammesse è risultato, come da verbale apertura economica del 14/03/2023, quanto segue:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 80.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Getinge Italia S.r.l.	€ 54.408,00	70	30	100,00
2^	CS Med S.r.l.	€ 66.000,00	50,72	25,58	76,30
3^	Laite S.r.l.	€ 66.506,00	45,65	25,33	70,98
4^	I.M. Medical S.a.s	€ 62.800,00	43,62	27,03	70,65

Ribasso offerta ditta aggiudicataria: - 31,99%

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 123.700,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1^	Getinge Italia S.r.l.	€ 114.091,00	70	29,07	99,07
2^	CS Med S.r.l.	€ 113.800,00	53,77	29,35	83,12
3^	I.M. Medical S.a.s	€ 113.072,00	49,71	30	79,71

Ribasso offerta ditta aggiudicataria: - 7,68%

Tenuto conto che l'offerta della ditta Getinge Italia S.r.l. ha realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro quinti dei punti relativi alla qualità, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 50/16, è stato chiesto alla ditta sopra indicata di presentare le giustificazioni relative alle voci di prezzo che hanno concorso a formare l'importo complessivo proposto. A seguito della documentazione inviata dalla ditta Getinge Italia S.r.l. non sono stati riscontrati elementi tali da ritenere l'offerta non congrua, come da verbale agli atti datato 24/03/2023.

Si propone pertanto di aggiudicare, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, la procedura aperta telematica SINTEL n. 158162016, relativa alla fornitura di "Pensili e scialitiche" per reparti vari dell'Azienda Ospedale – Università Padova alla ditta Getinge Italia S.r.l. risultata prima in graduatoria per entrambi i lotti per un importo complessivo di € 168.499,00 IVA esclusa, che viene dettagliato nelle offerte della ditta aggiudicataria allegate al Verbale apertura economica del 14/03/2023.

Si evidenzia che la procedura in disamina non è allo stato attuale oggetto

Regione del Veneto

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

di gare centralizzate a livello regionale e neppure di convenzioni attive della CONSIP.

Viene approntata la presente deliberazione avendo presente quanto disposto dalla normativa vigente, ed in particolare, dall'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016.

Tutto ciò premesso:

IL DIRETTORE GENERALE

PRESO ATTO della suesesa proposta e accertato che il Direttore della **UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica** ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla conformità con la vigente legislazione statale e regionale, nonché la copertura della spesa prevista nel budget assegnato per l'anno in corso;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni e le leggi regionali n. 55 e n. 56 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli dal D.P.G.R. n. 29 del 26.02.2021.

DELIBERA

Per le motivazioni riportate in premessa:

1. di prendere atto del Verbale della seduta di apertura delle offerte economiche, con allegati i Verbali della Commissione Giudicatrice e le offerte della ditta risultante prima in graduatoria, allegato al presente provvedimento di cui ne fa parte integrante e sostanziale;
2. di aggiudicare alla seguente ditta:
 - ✓ Lotto 1 – ditta Getinge Italia S.r.l. per un importo di € 54.408,00 IVA esclusa - CIG 9363531638
 - ✓ Lotto 2 – ditta Getinge Italia S.r.l. per un importo di € 114.091,00 IVA esclusa - CIG 93635440F4per un importo complessivo di fornitura per Pensili e scialitiche pari a € 168.499,00 IVA 22% esclusa;
3. di dare atto che stipula del contratto avverrà, se ed in quanto divenuta efficace l'aggiudicazione, nella forma di cui all'art. 32

Regione del Veneto
AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA

comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016;

4. di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC), ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della UOC Neurochirurgia e il Direttore della UOC Ostetricia e Ginecologia 1;
5. di dare atto che la spesa complessiva di € 205.568,78 IVA 22% inclusa sarà imputata al conto di costo n. 20024001 avente per oggetto "Attrezzature sanitarie e scientifiche" - esercizio finanziario 2023;
6. di dare atto che gli atti essenziali richiesti dal D.Lgs. n. 33/2013 saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Aziendale Ospedale - Università Padova;
7. di delegare il Direttore della UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica alla firma di tutti gli atti inerenti e conseguenti all'esecuzione della presente deliberazione.

Il Direttore Generale
F.to Dr. Giuseppe Dal Ben

U.O.C. PROVVEDITORATO, ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

ID 21A170_4 – PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PENSILE E SCIALITICHE PER REPARTI VARI DELL’AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA’ PADOVA.

VERBALE APERTURA BUSTA ECONOMICA del 14/03/2023

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 14 del mese di marzo alle ore 12:30 in Padova, Viale della Navigazione Interna, 38 presso la U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica, ha luogo la seduta riservata per l’apertura delle offerte economiche delle ditte ammesse alla gara in oggetto indetta con Deliberazione del Direttore Generale n. 1649 del 05/08/2022.

Si prende atto che:

- la procedura è costituita da n. 2 lotti e viene espletata tramite la piattaforma telematica SINTEL ID n. 158162016.

Il seggio di gara nominato con nota prot. n. 63821 del 29/09/2022, è costituito da:

- Dott.ssa Maria Elena Serafin, in qualità di autorità di gara,
- Rag. Fabio Moro in qualità di teste e verbalizzante.

Si prende atto che la Commissione Giudicatrice, nominata con Deliberazione del Direttore Generale n. 2385 del 11/11/2022, ha provveduto alla valutazione delle offerte tecniche presentate dalle seguenti ditte:

- ✓ CS Med S.r.l. per i lotti 1 e 2
- ✓ Getinge Italia S.r.l. per i lotti 1 e 2
- ✓ I.M. Medical S.a.s. per i lotti 1 e 2
- ✓ Laite S.r.l. per il lotto 1

precedentemente ammesse, come da verbali del 03/10/2022 e del 06/10/2022 già pubblicati nella piattaforma telematica sintel e nel sito aziendale.

In via preliminare vengono ricordate le modalità di aggiudicazione che avverrà sulla base di quanto stabilito dall’articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e cioè a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base dei seguenti criteri: Qualità punteggio massimo 70 punti (sulla base dei

criteri riportati nel Capitolato Speciale), Prezzo punteggio massimo 30 punti.

L'autorità di gara, quindi, procede con l'inserimento dei punteggi qualità assegnati dalla Commissione Giudicatrice sulla piattaforma telematica Sintel e successivamente procede all'apertura delle buste telematiche contenenti l'offerta economica con i seguenti esiti:

LOTTO 1 – Importo a base d'asta € 80.000,00

Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Getinge Italia S.r.l.	€ 54.408,00	70	30	100,00
2 [^]	CS Med S.r.l.	€ 66.000,00	50,72	25,58	76,30
3 [^]	Laite S.r.l.	€ 66.506,00	45,65	25,33	70,98
4 [^]	I.M. Medical S.a.s	€ 62.800,00	43,62	27,03	70,65

LOTTO 2 – Importo a base d'asta € 123.700,00


Pos.ne	Ditta	Offerta	P. Qualità	P. Prezzo	TOTALE
1 [^]	Getinge Italia S.r.l.	€ 114.091,00	70	29,07	99,07
2 [^]	CS Med S.r.l.	€ 113.800,00	53,77	29,35	83,12
3 [^]	I.M. Medical S.a.s	€ 113.072,00	49,71	30	79,71

Dal momento che le offerte della ditta Getinge Italia S.r.l. per i lotti 1 e 2 hanno realizzato sia i quattro quinti dei punti relativi al prezzo che i quattro punti relativi alla qualità, ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. n. 50/2016, sarà cura della Stazione Appaltante richiedere alla ditta sopraindicata la presentazione delle giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo proposto.

La seduta viene chiusa alle ore 13:00.

Viene redatto il presente verbale, composto da 2 (due) facciate e 5 (cinque) allegati costituiti da: Verbali della Commissione Giudicatrice del 21/12/2022, 31/01/2023 e 16/02/2023, offerte della ditta Getinge Italia S.r.l. per i lotti 1 e 2, che vengono allegati al presente Verbale, sottoscritto come segue, previa lettura e conferma.

Dott.ssa Maria Elena Serafin – Autorità di gara



Rag. Fabio Moro – teste e verbalizzante



VERBALE DI RIUNIONE

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
21/12/2022	08:00	09:00
OGGETTO: 1° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 21A170_4 "Pensile e scialitiche" per le sale operatorie della U.O.C. Neurochirurgia e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale - Università Padova.		
PRESENTI		
Presidente:	Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia	
Componenti:	Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1	
	PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	
Segretario Verbalizzante:	Collaboratore Amministrativo Moro Fabio - U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

Tramite la piattaforma Google Meet si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 2385 del 11/11/2022 per dare avvio ai lavori della gara in oggetto.

Il Presidente della Commissione, insieme ai componenti, stabilisce le modalità e i tempi dei lavori della Commissione:

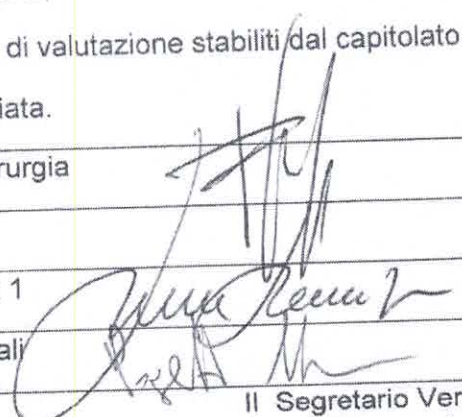
1° step: verifica dei requisiti minimi dei "Pensile e scialitiche" offerti dalle ditte: Getinge Italia S.r.l. per i lotti 1 e 2, CS Med S.r.l. per i lotti 1 e 2, Laite S.r.l. per il lotto 1 e I.M. Medical sas per il lotto 1 sulla base della documentazione tecnica presentata.

2° step: eventuale richiesta di demo alle ditte partecipanti;

3° step: attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti dal capitolato.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata.

Presidente :	Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia
Componenti:	
	Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1
	PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali


Il Segretario Verbalizzante
Moro Fabio

AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITÀ PADOVA

Via Giustiniani, 1 – 35128 PADOVA – Tel. + 39 049 8211111
Cod.Fisc./P.IVA 00349040287 – www.aopd.veneto.it – P.E.C.: protocollo.aopd@pecveneto.it

VERBALE DI RIUNIONE

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
31/01/2023	14:00	17:20
OGGETTO: 2° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 21A170_4 "Pensile e scialitiche" per le sale operatorie della U.O.C. Neurochirurgia e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale - Università Padova.		
PRESENTI		
Presidente:	Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia	
Componenti:	Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1	
	PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	
Segretario Verbalizzante:	Collaboratore Amministrativo Moro Fabio - U.O.C Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	




ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

La Commissione Giudicatrice si riunisce presso la sala riunioni della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali per incontrare le ditte concorrenti per la presentazione/dimostrazione dei prodotti proposti in gara, sulla base della scaletta a suo tempo comunicata alle ditte e che prevede un tempo di presentazione di circa 40' per le ditte partecipanti a due lotti e di 20' per la ditta che partecipa ad un solo lotto.

L'incontro con le ditte termina alle ore 17:00 i lavori della Commissione terminano alle ore 17:20..

Il prossimo incontro della Commissione viene fissato per giovedì 16 febbraio alle ore 14:00

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata.

Presidente : Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia	
Componenti:	
Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1	
PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	

Il Segretario Verbalizzante
Moro Fabio

VERBALE DI RIUNIONE

DATA	ORA DI INIZIO	ORA DI FINE
16/02/2023	14:00	17:10
OGGETTO: 3° incontro lavori commissione giudicatrice gara ID 21A170_4 "Pensile e scialitiche" per le sale operatorie della U.O.C. Neurochirurgia e della U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale - Università Padova.		
PRESENTI		
Presidente:	Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia	
Componenti:	Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1	
	PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali	
Segretario Verbalizzante:	Collaboratore Amministrativo Moro Fabio - U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica	

ELEMENTI EMERSI DALLA DISCUSSIONE

Presso la sala riunioni della U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali si riunisce la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 2385 del 11/11/2022 per dare seguito ai lavori della gara in oggetto.

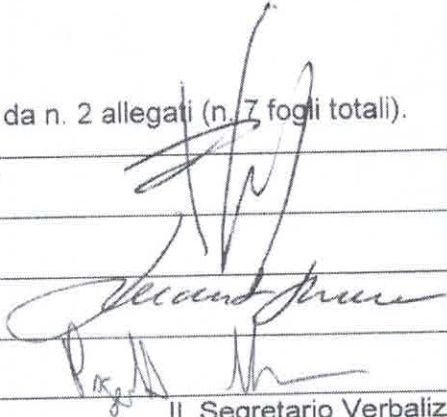
La Commissione sulla base della documentazione tecnica esaminata e dell'incontro del 31/01/2023 procede all'assegnazione dei punteggi di qualità, e all'elaborazione delle relative motivazioni, come riportato nelle tabelle allegate al presente verbale di cui ne fanno parte integrante e sostanziale (n. 4 fogli per il lotto 1 e n. 3 fogli per il lotto 2).

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata e n. 2 (due) allegati composti da n. 4 e n. 3 fogli).

L'incontro con le ditte termina alle ore 17:10.

Viene redatto il presente verbale, composto da 1 facciata e da n. 2 allegati (n. 7 fogli totali).

Presidente :	Dott. Francesco Volpin – U.O.C. Neurochirurgia
Componenti:	
	Dott. Marco Noventa – U.O.C. Ostetricia e Ginecologia 1
	PI Mauro Pagetta – U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali


Il Segretario Verbalizzante
Moro Fabio

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170. 4 Fornitura di scialfiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	I.M. MEDICAL			
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	Motivazione
1	Caratteristiche tecniche generali	15	9	0,6	Buono - Giudizio complessivo buono, struttura, qualità dei materiali e movimentazioni adeguate.
	Struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza				
	Caratteristiche illuminotecniche	20	12	0,6	Buono - La lampada non ha la possibilità di regolazione della luce endoscopica
	Caratteristiche illuminotecniche e possibilità di regolazione dei parametri				
	Caratteristiche funzionali e prova pratica	30	18	0,6	Buono - Buone caratteristiche funzionali. Le movimentazioni risultano adeguate, poco fluide.
Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione, facilità di movimentazione					
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia	5	4	0,8	Molto buono - Garanzia 24 mesi	
Qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, al fermo impianto annui massimi garantiti					
TOTALE		70	43		

43,62

RIPARAMETRAZIONE:

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170_4 Fornitura di scientifiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	GETINGE		
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente
1	Caratteristiche tecniche generali	15	15	1
	Struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza			
	Caratteristiche illuminotecniche	20	20	1
	Caratteristiche illuminotecniche e possibilità di regolazione dei parametri			
	Caratteristiche funzionali e prova pratica	30	30	1
Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione, facilità di movimentazione				
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia				
Qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, al fermo impianto annui massimi garantiti				
TOTALE		70	69	0,8

RIPARAMETRIZIONE:

70

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170 - 4 Fornitura di scalfitiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	CS MED		
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente
1	Caratteristiche tecniche generali	15	9	0,6
	Struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza			
	Caratteristiche illuminotecniche	20	12	0,6
	Caratteristiche illuminotecniche e possibilità di regolazione dei parametri			
	Caratteristiche funzionali e prova pratica	30	24	0,8
Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione, facilità di movimentazione				
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia	5	5	1	
Qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, ai fermo impianto annui massimi garantiti				
TOTALE		70	50	

50,72

RIPARAMETRAZIONE:

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170_4 Fornitura di scialtistiche per le sale operatorie della UOC Neurochirurgia dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	LAITE			Motivazione
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	
1	Caratteristiche tecniche generali	15	9	0,6	Buono - Giudizio complessivo buono, struttura, qualità dei materiali adeguate per caratteristiche richieste.
	Struttura, qualità dei materiali, movimentazioni, portata, sistemi di sicurezza	20	20	1	Ottimo - La lampada presenta delle performance ottimali e delle regolazioni di parametri adeguati
	Caratteristiche illuminotecniche	30	12	0,4	Discreto - Le caratteristiche previste nel criterio non è stato possibile valutarle nella loro interezza.
	Caratteristiche funzionali e prova pratica	5	4	0,8	Molto buono - Garanzia 24 mesi
	Facilità di utilizzo, confort e sicurezza del paziente, facilità pulizia ed igienizzazione, facilità di movimentazione				
Servizio di assistenza tecnica durante il periodo di garanzia					
Qualità del Servizio di Assistenza Tecnica con particolare riferimento all'organizzazione tecnica, ai tempi di intervento, al fermo impianto annui massimi garantiti					
TOTALE		70	45		

RIPARAMETRAZIONE:

45,65

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170 4 Fornitura di pensill e scialtiche per le sale operatorie della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale
Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	I.M. MEDICAL		
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente
2	Tipologia di soluzione proposta	10	10	1
	Progetto della soluzione proposta, rendering, layout e posizionamento apparecchiature nella sala operatoria			
	Design e struttura delle apparecchiature	10	8	0,8
	Materiale costruttivo, rifiniture, assenza di spigoli vivi, fessure ed interruzioni delle superfici esterne, assenza di canalizzazioni o spazi non chiusi			
	Ergonomia e manovrabilità	20	12	0,6
	Ergonomia e facilità di movimentazione del sistema all'interno della sala operatoria. Tipologia dei sistemi di aggancio a soffitto delle lampade per implementazione di ulteriori bracci			
Caratteristiche della lampada scialtica	25	15	0,6	
Soluzioni tecniche adottate, qualità costruttiva e dei materiali utilizzati, tipologia dei led, colore ed omogeneità dei led, vita utile dei led, caratteristiche dimensionali in funzione degli spazi, minima interferenza con i flussi laminari, ergonomia e manovrabilità dei corpi lampada. Caratteristiche per modalità di illuminazione endoscopica. Innovazioni tecnologiche. Caratteristica telecamera.				
Manutenzione e assistenza tecnica	5	4	0,8	
Semplicità ed accessibilità delle parti soggette a manutenzione				
TOTALE		70	49	

RIPARAMETRAZIONE:

49,71

Procedura di gara OGGETTO:ID 21A170_4 Fornitura di pensili e scialfatiche per le sale operatorie della UOC Ostetricia e Ginecologia 1 dell'Azienda Ospedale-Università Padova

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	GETINGE			
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente	Motivazione
2	Tipologia di soluzione proposta	10	10	1	Ottimo - Il progetto presentato soddisfa pienamente quanto richiesto
	Progetto della soluzione proposta, rendering, layout e posizionamento apparecchiature nella sala operatoria				
	Design e struttura delle apparecchiature	10	10	1	Ottimo - Minimizzazione di fessure, interruzioni delle superfici esterne, canalizzazione. Nella colonna porta utenze la barra ha un profilo estruso in alluminio corrodato nella parte centrale da un profilo in gomma ad alta densità
	Materiale costruttivo, rifiniture, assenza di spigoli vivi, fessure ed interruzioni delle superfici esterne, assenza di canalizzazioni o spazi non chiusi				
	Ergonomia e manovrabilità	20	20	1	Ottimo - Ergonomia e manovrabilità ottima. La struttura a petalo permette un posizionamento delle lampade ravvicinato con conseguente maggiore efficacia dell'illuminazione. Facilità di movimentazione, movimenti fluidi e omogenei
	Ergonomia e facilità di movimentazione del sistema all'interno della sala operatoria. Tipologia dei sistemi di aggancio a soffitto delle lampade per implementazione di ulteriori bracci				
	Caratteristiche della lampada scialfatica	25	25	1	Ottimo - Tutte le caratteristiche richieste sono ampiamente soddisfatte
	Soluzioni tecniche adottate, qualità costruttiva e dei materiali utilizzati, tipologia dei led, colore ed omogeneità dei led, vita utile dei led, caratteristiche dimensionali in funzione degli spazi, minima interferenza con i flussi laminari, ergonomia e manovrabilità dei corpi lampada. Caratteristiche per modalità di illuminazione endoscopica. Innovazioni tecnologiche. Caratteristica telecamera.				
	Manutenzione e assistenza tecnica	5	4	0,8	Molto buono - Garanzia 24 mesi
	Semplicità ed accessibilità delle parti soggette a manutenzione				
TOTALE		70	69		

RIPARAMETRAZIONE:

70

VALUTAZIONE

Lotto	CRITERIO	CS MED		
		Punteggio massimo	Punteggio	Coefficiente
2	Tipologia di soluzione proposta	10	8	0,8
	Progetto della soluzione proposta, rendering, layout e posizionamento apparecchiature nella sala operatoria			
	Design e struttura delle apparecchiature	10	8	0,8
	Materiale costruttivo, rifiniture, assenza di spigoli vivi, fessure ed interruzioni delle superfici esterne, assenza di canalizzazioni o spazi non chiusi			
	Ergonomia e manovrabilità	20	12	0,6
	Ergonomia e facilità di movimentazione del sistema all'interno della sala operatoria. Tipologia dei sistemi di aggancio a soffitto delle lampade per implementazione di ulteriori bracci			
	Caratteristiche della lampada scialitica	25	20	0,8
	Soluzioni tecniche adottate, qualità costruttiva e dei materiali utilizzati, tipologia dei led, colore ed omogeneità dei led, vita utile dei led, caratteristiche dimensionali in funzione degli spazi, minima interferenza con i flussi laminari, ergonomia e manovrabilità dei corpi lampada. Caratteristiche per modalità di illuminazione endoscopica. Innovazioni tecnologiche. Caratteristica telecamera.			
	Manutenzione e assistenza tecnica	5	5	1
	Semplicità ed accessibilità delle parti soggette a manutenzione			
TOTALE		70	53	

RIPARAMETRAZIONE:

53,77

OGGETTO: ID 21A170_4 - Fornitura di PENSILI e SCIALITICHE PER LE SALE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA E DELLA UOC OSTETRICA E GINECOLOGIA 1 DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

La scrivente impresa Getinge Italia Srl, con sede legale in Cinisello Balsamo, Via Gozzano 14, avente P.I./C.F. n. 03999220966, nella persona del Legale Rappresentante Roberto Chareun, nato a Torino, il 07/11/1970, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e vincolante:

Lotto	Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio nuovo Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D. Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento)	Quantità	Prezzo unitario (MAX 5 decimali)	IVA %	Prezzo complessivo (prezzo unitario x q.tà)
		<i>Sale operatorie UOC Neurochirurgia</i>									
1	1	Lampade scialitiche a led per installazione a soffitto, a 4 bracci completa di sedile e predisposizione per monitor e telecamera Full HD	Volice 64 DF TK AIM + Braccio porta monitor + Braccio porta telecamera	VST 64 DF TK AIM MIR + EQTHSD10 SAT 12 + EQTHD 127	Getinge	312010701	n.d.	2	27.204,00000 €	22%	54.408,00000 €
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA										€	54.408,0000000
BASE D'ASTA											31,99000000%

Tutti i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

INDICARE LA PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE PER EVENTUALI ACQUISTI COME DA PUNTO 3.9 DEL DISCIPLINARE DI GARA: 10 %, PERCENTUALE CHE RIMARRA' FISSA ED INVARIATA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA (24 MESI)

Contratto annuale di manutenzione post garanzia (valido per 24 mesi) : 6% dell'importo offerto delle apparecchiature sopraindicate

Oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 compresi nei prezzi offerti: 1%.

Costo della manodopera relativo alle prestazioni in oggetto di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 compreso nei prezzi offerti: € 4.240,80

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribass d'asta: € 1.000,00

Oneri per rischi interferenziali connessi alle attività di coordinamento: € 1.000,00

OGGETTO: ID 21A170_4 - Fornitura di PENSILI e SCIALITICHE PER LE SALE DELLA UOC NEUROCHIRURGIA E DELLA UOC OSTETRICA e GINECOLOGIA 1 DELL'AZIENDA OSPEDALE - UNIVERSITA' PADOVA

La scrivente impresa Getinge Italia Srl, con sede legale in Cinesello Balsamo, Via Gozzano 14, avenue P.I./C.F. n. 03992220966, nella persona del legale Rappresentante Roberto Chareur, nato a Torino, il 07/11/1970, in riferimento alla Procedura in oggetto, preso atto delle modalità di espletamento della gara e delle condizioni che regolano la fornitura in oggetto, formula la seguente offerta economica impegnativa e vincolante:

Lotto Rif.	Descrizione prodotto	Nome commerciale	Codice prodotto	Marca prodotto	CND	Numero iscrizione repertorio nuovo Regolamento UE 2017/745 (o alla Direttiva 93/42/CEE recepita con D.Lgs. 24 febbraio 1997 n. 46 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo transitorio di entrata in vigore del citato Regolamento)	Quantità	Prezzo unitario (MAX 5 decimali)	IVA %	Prezzo complessivo (prezzo unitario x q.ta)
Sala operatoria UOC Ostetrica e Ginecologia										
2	Lampada scalifica ad alta tecnologia a soffitto a 3 bracci	Volista 64 DF TK AIM + Braccio porta monitor	VST 64 DF TK AIM NIR + EQ7XHD L27	Getinge	212010701	n.d.	1	26.113,00000 €	22%	26.113,00000 €
2	Pensile per anestesia	Modello RIG II + Braccio paramonitor	RIG II + EQ7XHD L27	Getinge	2125007	151296	1	12.172,00000 €	22%	12.172,00000 €
2	Lampada scalifica ad alta tecnologia a soffitto a 3 bracci + Smontaggio 2° braccio su pensile chirurgico esistente	Volista 64 DF TK AIM + Braccio porta monitor	VST 64 DF TK AIM NIR + EQ7XHD L27	Getinge	212010701	n.d.	1	26.113,00000 €	22%	26.113,00000 €
2	Lampada scalifica ad alta tecnologia a soffitto a 2 bracci + Smontaggio 2° braccio su pensile chirurgico esistente	Volista 64 DF TK AIM	VST 64 DF TK AIM NIR	Getinge	212010701	n.d.	1	21.287,00000 €	22%	21.287,00000 €
2	Lampada scalifica ad alta tecnologia a soffitto a 2 bracci	Volista 64 DF TK AIM	VST 64 DF TK AIM NIR	Getinge	212010701	n.d.	1	21.287,00000 €	22%	21.287,00000 €
2	Telecamera Full HD su manubrio	Telecamera Full HD	CHDIT AIR 03 QL FHD E	Getinge	212010701	n.d.	1	7.119,00000 €	22%	7.119,00000 €
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA										€ 114.091,00000000
TOTALE PERCENTUALE DI RIBASSO SULLA BASE D'ASTA										7,7679871%

Tutti i prezzi sopraindicati sono impegnativi e irrevocabili per almeno 240 giorni a decorrere dalla data ultima fissata per la presentazione dell'offerta.

INDICARE LA PERCENTUALE DI SCONTO DA APPLICARE PER EVENTUALI ACQUISTI COME DA PUNTO 3.9 DEL DISCIPLINARE DI GARA: 10 %, PERCENTUALE CHE RIMARRA' FISSA ED INVARIATA PER TUTTA LA DURATA DELLA GARANZIA (24 MESI)

Contratto annuale di manutenzione post garanzia (valido per 24 mesi) : 6% dell'importo offerto delle apparecchiature sopraindicate

Oneri di sicurezza aziendali di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 compresi nei prezzi offerti: 1%.

Costo della manodopera relativo alle prestazioni in oggetto di cui all'art. 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 compreso nei prezzi offerti: € 10.648,50

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta: € 2.000,00

Oneri per rischi interferenziali connessi alle attività di coordinamento: € 1.100,00

Struttura economica dell'offerta, con particolare riferimento alle voci di prezzo indicate negli articoli 96, e, 10 e nell'art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

Si chiede di compilare il seguente fac-simile di schema di dettaglio:

Voci di prezzo	%	costo
costi industriali		
costi generali		
costi della manodopera		
costi per le spese per la salute e sicurezza dei lavoratori per il rischio specifico, voluttari del datore di lavoro (ditta partecipante)		
costi per la formazione del personale		
eventuali altri costi		
utili di impresa		

CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA:

- **RESA:** franco destino.
- **IMBALLLO e TRASPORTO:** compresi.
- **INSTALLAZIONE:** compresa.
- **MONTAGGIO e COLLAUDO:** compresi.
L'installazione consiste nell'allaccio ai punti di consegna impiantistici già predisposti dal Committente; restano quindi a carico del Committente le eventuali opere accessorie necessarie al montaggio delle apparecchiature proposte:
- lavori e le opere di qualsiasi natura (verifiche strutturali, murine e di fondazione - es. fissaggio dei sistemi di ancoraggio e tenuta a soffitto era pavimento etc) o parate con relative certificazioni - idrauliche - elettriche di collegamento alla rete e fra i vari accessori - es. predisposizione delle linee elettriche necessarie e relative canaline dal quadro elettrico alle singole utenze, come da norma C.E.I. 64-8 e C.E.I. 64-07/10 - audio/video, gas - es. predisposizione delle tubazioni gas medicali all'attacco delle flange di ancoraggio, come da Norma UNI 9507 e UNI EN ISO 7396-1 e UNI EN ISO 7396-2) occorrenti per l'installazione;
- eventuale fornitura di indirizzi IP e reti dati necessari per il funzionamento delle apparecchiature
- il personale di manovalanza e i mezzi d'opera necessari alla movimentazione dei beni sino al punto di installazione con adeguati mezzi (ascensori, montacarichi, gru);
- l'approntamento di locali per accogliere e custodire i materiali ed i mezzi di montaggio, gli attrezzi di proprietà della Fornitrice, gli effetti personali dei montatori;
- Eventuali lampadine di finitura in inox, se non espressamente previsto in offerta
- Eventuale smontaggio di attrezzature esistenti se non espressamente previsto in offerta
Il dettaglio delle eventuali predisposizioni (elettriche, idrauliche, etc) non comprese nell'offerta è esplicitato nel documento eventualmente allegato
Al momento della consegna/colloquio al cliente la Getinge Italia S.r.l. provvederà alla verifica degli apparecchi alla a comprovare il corretto funzionamento dei beni forniti secondo le normative di settore applicabili e vigenti (es. UNI 11100). In detta sede verrà predisposto e sottoscritto un verbale di collaudo attestante l'avvenuta installazione ed il corretto funzionamento degli apparecchi stessi. Il verbale di collaudo sarà sottoscritto da entrambe le parti.
Per le apparecchiature di lavaggio e sterilizzazione, se non espressamente previsto in offerta, si intendono comprese le sole IQ e OQ (un ciclo)
- **SUBAPPALTO:** La scrivente dichiara sin da ora che in caso di aggiudicazione, pur non cedendo l'oggetto del contratto, intende riservarsi la facoltà di subappaltare i lavori necessari per l'installazione delle apparecchiature offerte osservando la disciplina contenuta nell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
- **FATTURAZIONE:** al collaudo.
- **PAGAMENTO:** 60 gg data fattura.
- **INTERESSI DI MORA:** sui pagamenti ritardati verranno conteggiati, di pieno diritto e senza alcuna messa in mora, gli interessi così come previsto dal D.Lgs. 231/2002, senza che per questo il Committente possa ritenersi in facoltà di differire i pagamenti.
- **GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO:** il periodo di garanzia delle apparecchiature offerte è di 24 mesi a decorrere dalla data del collaudo, ad eccezione del materiale e delle parti soggetta in genere ad usura (elettrodi, cavi paziente, trasduttori, sonde, batterie, kit manutenzione, celle ossigeno, caterini, cassetta paziente, volume infusor, lampadine, manopole, materassi, tel. batteria, ecc.) e del materiale di consumo.
Sono esclusi dalla garanzia i guasti causati da incidenti o da inutilizzo, o da mancato uso, dolo da parte degli utilizzatori o derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni d'uso delle attrezzature.
Dalle operazioni di manutenzione sono esclusi, in quanto non di competenza, i controlli in merito alle norme vigenti contro gli infortuni (ad es. il controllo dell'impianto elettrico, dei collegamenti delle terre, delle protezioni anti-x etc.).
- **CONSEGNA:** entro 90 giorni data ricevimento dell'ordine NSO
- **I.V.A.:** come per legge.
- **VALIDITA' DELLA PRESENTE OFFERTA:** come sopra indicato.

Crisolite Balsarmo, 16.09.2022

GETINGE ITALIA S.R.L.
ROBERTO CHAREUN
Legale Rappresentante

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione e' stata pubblicata in copia all Albo di questa Azienda Ospedaliera di Padova per 15 giorni consecutivi dal

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva il 3/4/2023

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)

Copia composta di n°22 fogli (incluso il presente) della delibera n. 694 del 3/4/2023 firmata digitalmente dal Direttore Generale e conservata secondo la normativa vigente presso Infocert S.p.a.

Padova, li

Il Direttore
UOC AFFARI GENERALI
(Avv.Maria Grazia Cali)
